

ГОСТ Р ИСО 1652—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛАТЕКС КАУЧУКОВЫЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ

www.rtstd-gost.narod.ru

Издание официальное

www.rtstd-gost.narod.ru

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

БЗ 12—92/1305



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИИ**ЛАТЕКС КАУЧУКОВЫЙ**

Определение вязкости

Rubber latex.
Determination of viscosity

ГОСТ Р**ИСО 1652—93**

ОКСТУ 2209 www.rtstd-gost.narod.ru

Дата введения 01.01.94**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения вязкости натуральных и синтетических каучуковых латексов.

Предусмотрено два прибора:

- 1) L — для определения вязкости до 2000 мПа·с (2000 сП);
- 2) R — для определения вязкости выше 200 мПа·с (200 сП).

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 24920—81 * Латексы синтетические. Правила приемки, отбор и подготовка проб.

ГОСТ 28862—90 Латексы каучуковые. Определение общего содержания сухого вещества.

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод определения вязкости образца латекса заключается в определении вязкости вискозиметром, определяющим крутящий момент на определенном шпинделе, врачающемся с постоянной скоростью при низкой скорости сдвига и погруженном на известную глубину в латекс.

Измерения можно проводить в неразбавленном латексе или разбавленном до требуемого общего содержания сухого вещества.

* Допускается до введения ИСО 123 в качестве государственного стандарта.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России.

4. АППАРАТУРА

4.1. Вискозиметр, состоящий из синхронного электрического мотора, приводящего во вращение с постоянной скоростью вал, к которому можно прикреплять шпинделы различных форм и размеров. Шпиндель погружают в латекс на определенную глубину и тормозящее усилие на шпинделе, вращающемся в латексе, создает крутящий момент на валу шпинделя. Созданный равновесный крутящий момент отмечается указателем на шкале, калиброванной от 0 до 100.

В приборе L крутящий момент составляет $(67,37 \pm 0,07)$ мкН·м ($673,7 \pm 0,7$) дин·см на полную шкалу;

в приборе R — $(718,7 \pm 0,7)$ мкН·м (7187 ± 7) дин·см.

Шпинделы должны быть выполнены в соответствии с чертежом с размерами, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Номер шпинделя	Размеры, мм					
	A $\pm 1,3$	B $\pm 0,03$	C $\pm 0,03$	D $\pm 0,06$	E $\pm 1,3$	F $\pm 0,15$
L_1	115,1	3,18	18,84	65,10	—	81,0
L_2	115,1	3,18	18,72	6,86	25,4	50,0
L_3	115,1	3,18	12,70	1,65	25,4	50,0
R_1	133,3	3,18	56,26*	22,48**	27,0	61,1
R_2	133,3	3,18	46,93	1,57	27,0	49,2
R_3	133,3	3,18	34,69	1,65	27,0	49,2

* Толщина стенки примерно 0,6 мм.


** Толщина стенки примерно 1,0 мм.

Формы шпинделей приведены на чертеже.

На корпус электродвигателя помещают уровень со спиртом или воздушным пузырьком, указывающий на вертикальное положение шпинделя, соединенного с валом двигателя.

Применяют ограждение для предохранения шпинделя в процессе работы, состоящее из прямоугольной полосы с сечением примерно $9,5 \times 3$ мм с закругленными углами, изогнутой в виде буквы U .

Верхние концы вертикальных стоек ограждения должны быть прочно прикреплены к корпусу электродвигателя, но так, чтобы ограждение можно было снимать для очистки. Радиус скругления между горизонтальным участком ограждения и вертикальными стойками должен быть равен 6 мм.

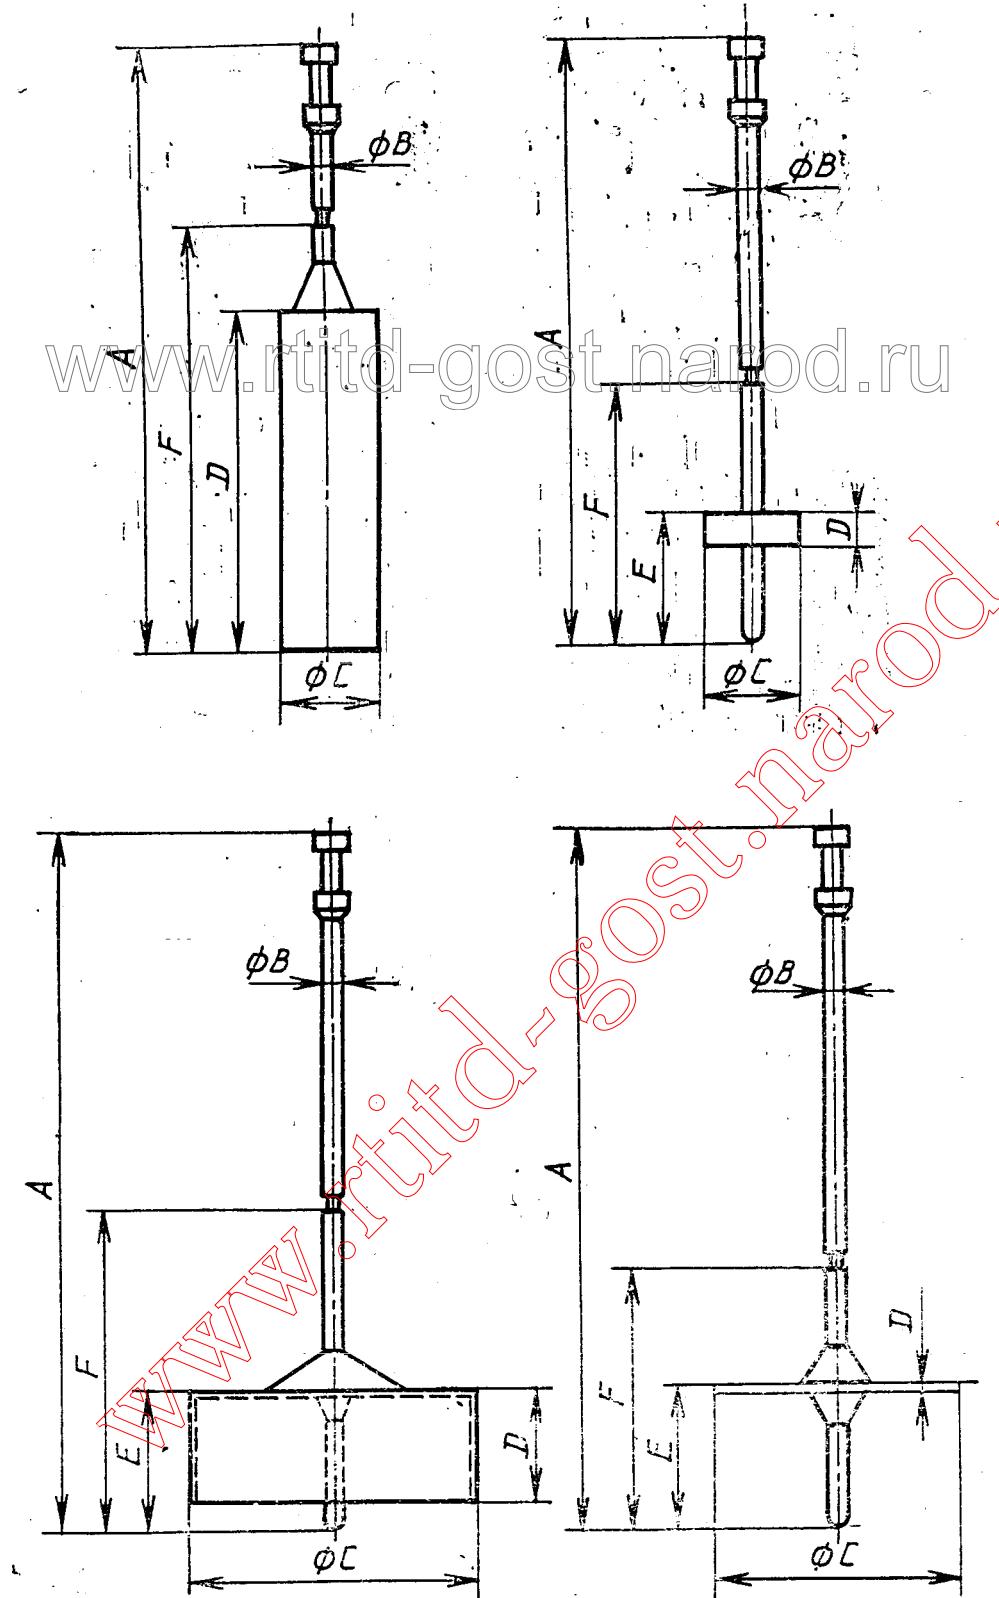

С. 4 ГОСТ Р ИСО 1652—93

Расстояние по вертикали между внутренними поверхностями двух вертикальных стоек ограждения, когда оно надежно прикреплено к корпусу электродвигателя, должно быть $(31,8 \pm 0,8)$ мм для прибора *L* и $(76,2 \pm 0,8)$ мм для прибора *R*. Расстояние по вертикали между верхней лицевой поверхностью горизонтального участка ограждения и нижней частью вала шпинделья, когда оно надежно прикреплено к корпусу электродвигателя, а шпиндель прикреплен к валу, должно быть не менее 10 мм для прибора *L* и не менее 4,5 мм для прибора *R*.

4.2. Стеклянный химический стакан внутренним диаметром не менее 85 мм и вместимостью не менее 600 см³.

4.3. Водяная баня, отрегулированная на температуру 25 или 27 °C в тропических странах.

5. ОТБОР ПРОБ

Пробы отбирают в соответствии с одним из методов ГОСТ 24920.

6. ПОДГОТОВКА ПРОБ

В соответствии с ГОСТ 28862 определяют общее содержание сухого вещества в латексе, затем, если необходимо, доводят его до требуемого значения добавлением дистиллированной воды или воды эквивалентной чистоты. К латексу медленно добавляют воду и осторожно перемешивают смесь в течение 5 мин, избегая попадания воздуха.

Если латекс содержит поглощенный воздух и имеет вязкость менее 200 мПа·с (200 сП), воздух удаляют, оставляя латекс на 24 ч.

Если латекс содержит поглощенный воздух, не содержит других летучих компонентов и имеет вязкость более 200 мПа·с (200 сП), воздух удаляют, оставляя латекс под вакуумом до прекращения выделения пены.

Если замечено присутствие коагулума, латекс осторожно процецивают через сетку с квадратными отверстиями со сторонами 500 мкм.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Образец (п. 6) заливают в химический стакан (п. 4.2). Помещают стакан в водянную баню (п. 4.3) с температурой 25 или 27 °C и осторожно перемешивают образец, пока его температура

не достигнет $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$ или $(27 \pm 2)^\circ\text{C}$. Записывают точную температуру. Сразу надежно прикрепляют шпиндель к валу электродвигателя, а ограждение к корпусу электродвигателя вискозиметра (п. 4.1). Шпиндель и ограждение аккуратно вводят в латекс таким образом, чтобы избежать захвата воздуха до тех пор, пока поверхность латекса не окажется в средней точке канавки на валу шпинделя. Шпиндель в латексе должен располагаться вертикально и находиться в центре химического стакана.

Выбирают скорость вращения:

для прибора L — $(60 \pm 0,2)$ мин $^{-1}$ ($1 \pm 0,003$ с $^{-1}$);

для прибора R — $(20 \pm 0,2)$ мин $^{-1}$ ($0,333 \pm 0,003$ с $^{-1}$).

Включают электродвигатель вискозиметра и снимают равновесное показание с точностью до единицы деления шкалы в соответствии с инструкциями изготовителя на прибор. До установления равновесного показания может пройти 20—30 с.

Для определения используют шпиндель с наименьшим порядковым номером, способный зарегистрировать измеряемую вязкость.

8. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

После снятия показаний вычисляют вязкость латекса в миллипаскалях в секунду (сантипуазах), используя соответствующий коэффициент, взятый из табл. 2.

Таблица 2

Коэффициент перевода показаний по шкале 0—100
в миллипаскалях в секунду (сантипуазы)

Номер шпинделя	Коэффициент
L_1	$\times 1$
L_2 или R_1	$\times 5$
L_3 или R_2	$\times 20$
R_3	$\times 50$

9. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать:

- 1) обозначение настоящего стандарта;
- 2) описание образца;
- 3) результаты и использованный метод выражения;
- 4) использованный прибор (L или R);

С. 6 ГОСТ Р ИСО 1652—93

- 5) номер шпинделя;
- 6) общее содержание сухого вещества латекса (разбавленного, если требуется);
- 7) температуру проведения испытания;
- 8) особенности определения;
- 9) операции, не отраженные в настоящем стандарте или стандартах, на которые делается ссылка, или необязательные.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 81 «Резиновые изделия бытовые и медицинского назначения»**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 12.05.93 № 134**
Настоящий стандарт подготовлен на основе аутентичного применения текста международного стандарта ИСО 1652—85 «Латекс каучуковый. Определение вязкости»
- 3. ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Раздел, в котором приведена ссылка
ГОСТ 24920—81	2,5
ГОСТ 28862—90	2,6